Informations concernant la batterie

Avertissement de batterie faible : A 20 minutes d'autonomie restante, le détecteur émettra un bip sonore, clignotera et affichera le message « LOW BAT ». Les notifications continueront d'être envoyées jusqu'à ce que la batterie expire et le détecteur s'éteigne automatiquement.

Chargement : Pendant la charge, l'icône de la batterie clignotera et le détecteur affichera un pourcentage de charge approximatif. Le détecteur est complètement rechargé en 4 à 6 heures.
Pour une charge plus rapide, chargez l'appareil lorsque le détecteur est éteint.

⚠ **Avertissement :** *NE rechargez PAS le détecteur dans une atmosphère inflammable.*

⚠ **Avertissement :** *NE chargez PAS le détecteur à des températures supérieures à 104 °F (40 °C) ou inférieures à 32 °F (0 °C).*

Vous avez d'autres questions ?

Pour obtenir plus de renseignements sur le détecteur **Multi Gas Clip** concernant la programmation, les tests de fonctionnement, l'étalonnage, etc., veuillez vous référer au **manuel d'utilisation du Multi Gas Clip**. Le manuel, les vidéos et autres informations utiles sont disponibles en consultation ou en téléchargement sur **www.gascliptech.com**.

Coordonnées

Gas Clip Technologies, Inc.
305 W. FM 1382, Suite 540
Cedar Hill, TX 75104 États-Unis
Téléphone : +1.972.775.7577
Fax : +1.972.775.2483
Numéro gratuit : 1.877.525.0808
Site web : www.gascliptech.com
Contact : gascliptech.com/contactus.php

ASSEMBLED IN USA

gas clip technologies

Portable Gas Detectors You Can Count On

MGC QSG v2.05

gas clip technologies

Portable Gas Detectors You Can Count On




Multi Gas Clip
Infrarouge

Guide de démarrage rapide

LIRE D'ABORD AVANT UTILISATION

Le **Multi Gas Clip** est un dispositif de sécurité individuel conçu pour détecter la présence de sulfure d'hydrogène (H_2S), de monoxyde de carbone (CO), d'oxygène (O_2) et les gaz inflammables (LIE). Avant toute utilisation, vous devez avoir suivi une formation adéquate sur le détecteur et sur les mesures appropriées à prendre en cas d'alarme.

Composants de l'écran

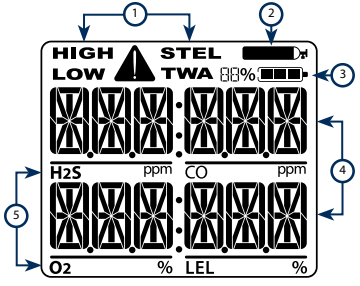

Icône	Description
1	État d'alarme
2	Mode étalonnage/test
3	Niveau de charge de la batterie
4	Mesures de gaz
5	Identifiants de gaz

Lorsqu'une valeur de gaz (4) dépasse son seuil d'alarme, le détecteur déclenchera une alarme visuelle, sonore et vibrante. Sur l'écran, l'icône ⚠ apparaîtra à côté de l'état d'alarme (1) et l'identifiant de gaz associé (5) clignotera de manière permanente.

⚠ **Avertissement** : *Les utilisateurs doivent se familiariser avec les icônes, que l'alarme se déclenche ou pas.*

⚠ **Avertissement** : *Si l'écran ne comporte pas d'icônes ou s'il est illisible, arrêtez d'utiliser le détecteur et communiquez avec Gas Clip Technologies.*

⚠ **Avertissement** : *Le capteur IR LIE ne détectera pas l'hydrogène (H_2) ou d'acétylène (C_2H_2). Cependant, en raison de leur sensibilité croisée, le capteur de CO se mettra en mode alarme bien en dessous d'une LIE de 10 %.*


Alarmes par défaut

Capteur	BAS	HAUT	TWA	STEL
H_2S	10 ppm	15 ppm	10 ppm	15 ppm
CO	35 ppm	200 ppm	35 ppm	50 ppm
O_2	19,5 %	23,5 %		
LIE	10 %	20 %		

Mise en marche du détecteur

Pour activer le détecteur, appuyez brièvement sur le bouton Power/menu. L'appareil émettra un signal sonore d'activation. Une fois activé, le détecteur commencera à afficher les valeurs mesurées des gaz immédiatement. Chaque identifiant de gaz affichera un « 0 » pour la valeur mesurée du gaz pendant la stabilisation et l'autotest. Une fois que tous les identifiants de gaz ont terminé la séquence de montée en température et de stabilisation, < 65 secondes, le détecteur sera prêt à détecter tous les gaz concernés. L'écran affichera :

Stabilisation



Entièrement opérationnel



⚠ **Avertissement** *: Avant chaque utilisation, vérifiez que tous les ports des capteurs et des alarmes ne sont pas bloqués ou obstrués.*

Arrêt du détecteur

Maintenez le bouton Power/menu enfoncé jusqu'à la fin du compte à rebours « OFF ». Pendant le compte à rebours, le détecteur émettra un bip sonore et clignotera 4 fois avant de s'éteindre. L'écran affichera :



Étalonnage manuel du détecteur

Maintenez enfoncé le bouton Power/menu pendant toute la durée du compte à rebours « OFF » et du compte à rebours « CAL » qui suit. Pendant ces deux comptes à rebours, le détecteur émettra un bip sonore et clignotera 8 fois, avec une pause entre chaque compte à rebours. Relâchez le bouton lorsque l'écran affiche le message « AUTO ZERO ». L'écran affiche ensuite « APPLY GAS ». Fixez le capuchon d'étalonnage MGC relié à un tuyau, un régulateur et une bouteille de gaz, puis injectez du gaz. L'étalonnage est terminé lorsque la date du prochain étalonnage s'affiche et que le détecteur passe au mode alarme. Coupez le gaz et retirez le capuchon d'étalonnage du détecteur. L'écran affichera les éléments suivants :



N.B. : L'étalonnage peut également être effectué à l'aide de la station d'accueil Multi Gas Clip Dock.